



Stroomschema voor keuze type inhalator

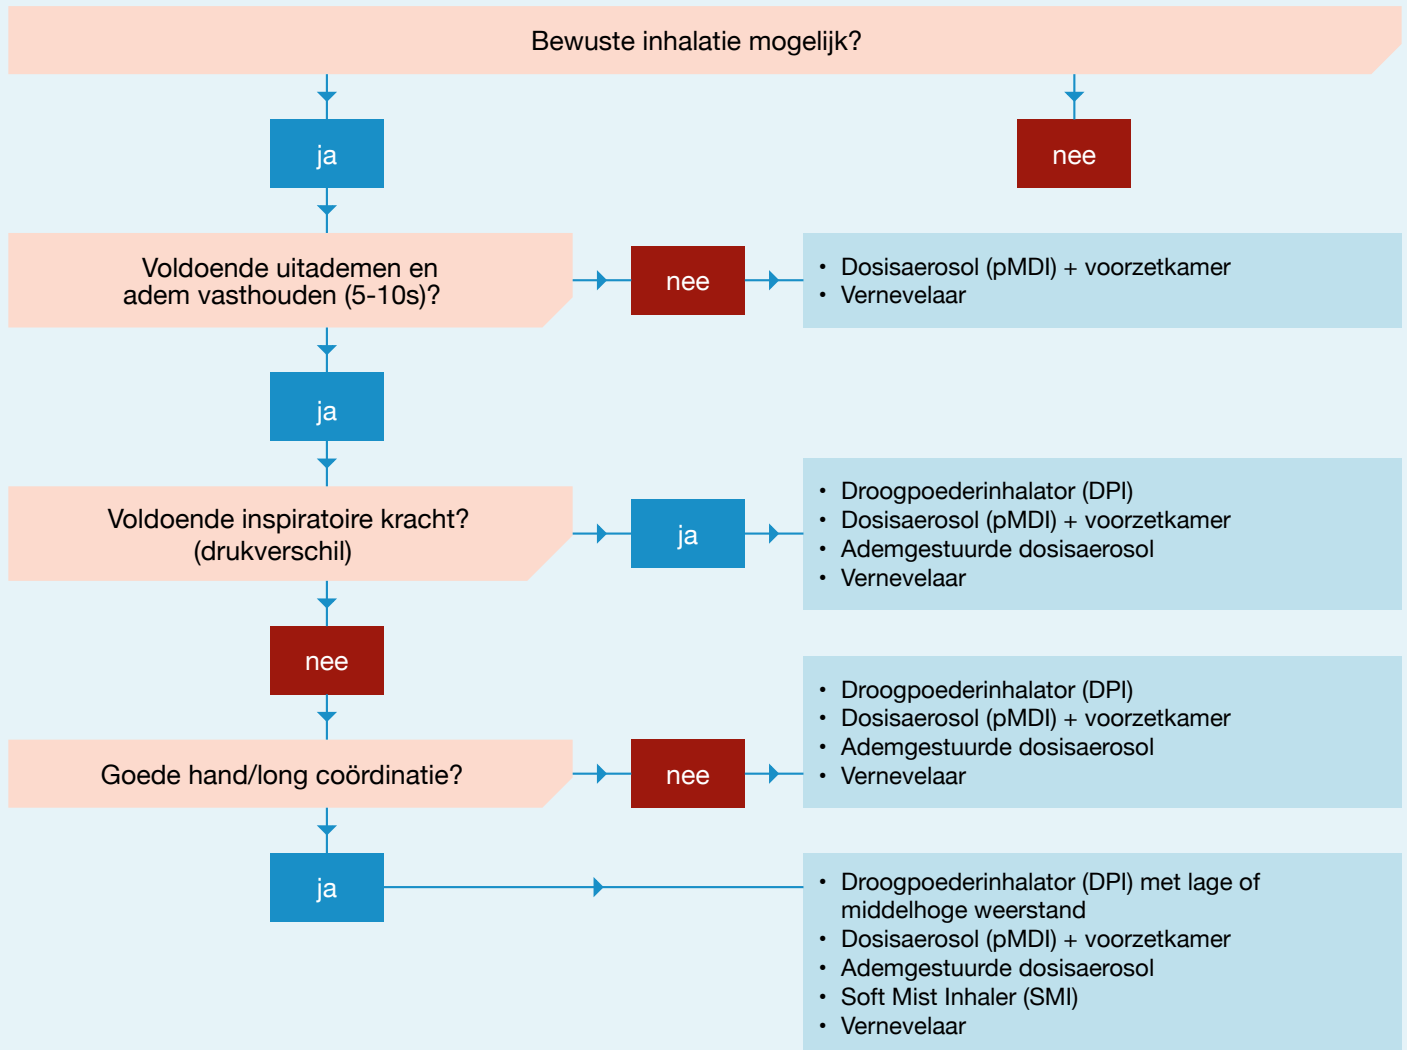

Voor alle inhalatoren geldt:

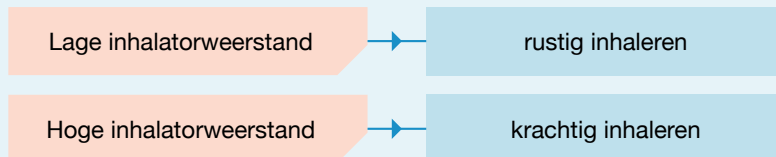

In-Check DIAL

Het apparaat meet de hoogste inspiratoire flow-snelheid en kan de weerstandskennmerken van de specifieke inhalator van een patiënt meten. Het is een hulpmiddel bij het maken van de keuze voor een type inhalator.

Uiteraard is dit slechts een richtlijn en moet de situatie individueel worden bekeken.